# 画像読取装置 定期試験報告書
## ― 2016年度 ―

| | |
|---|---|
| 試 験 日 | 2016年4月9日 ～ 2017年3月18日 |
| 試 験 者 | 本田 貢 |

| | | |
|---|---|---|
| 装置 1 | 型式: CALNEO U(立位) | シリアル番号: 07220159 |
| | メーカー: 富士フィルムメディカル | 設置場所: X線撮影室20 |
| 装置 2 | 型式: CALNEO MT(臥位) | シリアル番号: 07020060 |
| | メーカー: 富士フィルムメディカル | 設置場所: X線撮影室20 |
| 装置 3 | 型式: CALNEO U(立位) | シリアル番号: 07120136 |
| | メーカー: 富士フィルムメディカル | 設置場所: X線撮影室22 |
| 装置 4 | 型式: CALNEO MT(臥位) | シリアル番号: 07020049 |
| | メーカー: 富士フィルムメディカル | 設置場所: X線撮影室22 |

2016年度品質管理

| 画像読取装置 | | CALNEO U(立位) | | 相対感度 | 残像 | シェーディング | | | | | アーチファクト | 線形性 | | | 鮮鋭度 | | | | 幾何学歪み | | 画像ノイズ | | バーガーファントム | | | | ワイヤメッシュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置場所 | | X線撮影室20 | | | | 領域A | 領域B | 領域C | 領域D | 領域E | | △AB | △AC | △AD | 1c/mm (左右) | 2c/mm (左右) | 1c/mm (上下) | 2c/mm (上下) | 左右方向 | 上下方向 | 左右方向 | 上下方向 | φ8 | φ4 | φ2 | φ1 | |
| | | 管理幅 | 上限値 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | | | [redacted] | |
| | | | 基準値 | 480 | | 2,052 | 2,042 | 2,091 | 2,026 | 2,072 | | 712 | 1519 | 1992 | 0.5547 | 0.2820 | 0.5714 | 0.2873 | 102.4 | 102.4 | 6.3316 | 6.5296 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | | | 下限値 | [redacted] | | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| No. | 検査日 | 検査時間 | 実施者 | ±30% | | ±160QL | | | | | | ±80QL | | | ±10% | | | | ±3% | | ±20% | | | | | | |
| 1 | 20160409 | 14:25 | 本田 | 513 | 0 | 2054 | 2049 | 2101 | 2014 | 2066 | Pass | 714 | 1521 | 2004 | 0.5553 | 0.2813 | 0.5725 | 0.2996 | 102.2 | 102.3 | 6.2866 | 6.6465 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 20160514 | 14:57 | 本田 | 488 | 0 | 2053 | 2048 | 2100 | 2012 | 2065 | Pass | 713 | 1513 | 1980 | 0.5589 | 0.2823 | 0.5711 | 0.2897 | 102.3 | 102.3 | 6.1350 | 6.4840 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 20160625 | 15:31 | 本田 | 473 | 0 | 2048 | 2042 | 2100 | 2005 | 2063 | Pass | 715 | 1521 | 1997 | 0.5578 | 0.2767 | 0.5696 | 0.2903 | 102.3 | 102.3 | 6.1368 | 6.5038 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 20160723 | 15:30 | 本田 | 452 | 0 | 2053 | 2049 | 2105 | 2010 | 2067 | Pass | 715 | 1516 | 1978 | 0.5630 | 0.2755 | 0.5716 | 0.2827 | 102.3 | 102.5 | 5.9171 | 6.2241 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 20160819 | 20:13 | 本田 | 473 | 0 | 2053 | 2046 | 2105 | 2008 | 2068 | Pass | 715 | 1518 | 1985 | 0.5530 | 0.2798 | 0.5730 | 0.2969 | 102.3 | 102.3 | 6.0917 | 6.3969 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 20160916 | 20:00 | 本田 | 485 | 0 | 2052 | 2043 | 2105 | 2007 | 2070 | Pass | 712 | 1512 | 1980 | 0.5549 | 0.2709 | 0.5748 | 0.2832 | 102.3 | 102.3 | 6.2205 | 6.5119 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | 20161022 | 16:28 | 本田 | 496 | 0 | 2055 | 2047 | 2109 | 2010 | 2072 | Pass | 713 | 1511 | 1969 | 0.5489 | 0.2772 | 0.5748 | 0.2780 | 102.3 | 102.3 | 6.2579 | 6.5955 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | 20161126 | 15:08 | 本田 | 473 | 0 | 2056 | 2051 | 2108 | 2012 | 2068 | Pass | 714 | 1516 | 1973 | 0.5573 | 0.2705 | 0.5704 | 0.2857 | 102.3 | 102.5 | 6.1091 | 6.4731 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 20161224 | 14:44 | 本田 | 452 | 0 | 2049 | 2045 | 2101 | 2006 | 2061 | Pass | 716 | 1519 | 1989 | 0.5622 | 0.2860 | 0.5727 | 0.2870 | 102.5 | 102.3 | 5.9993 | 6.4432 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | 20170114 | 13:54 | 本田 | 469 | 0 | 2054 | 2049 | 2100 | 2014 | 2066 | Pass | 713 | 1519 | 1990 | 0.5590 | 0.2766 | 0.5796 | 0.2878 | 102.3 | 102.3 | 6.0526 | 6.4095 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | 20170225 | 13:12 | 本田 | 469 | 0 | 2053 | 2050 | 2099 | 2013 | 2063 | Pass | 714 | 1521 | 1996 | 0.5482 | 0.2830 | 0.5686 | 0.2770 | 102.3 | 102.3 | 6.0674 | 6.4086 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | 20170318 | 14:21 | 本田 | 479 | 0 | 2051 | 2048 | 2099 | 2012 | 2063 | Pass | 714 | 1519 | 1988 | 0.5491 | 0.2925 | 0.5676 | 0.2970 | 102.3 | 102.5 | 6.1542 | 6.5191 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |

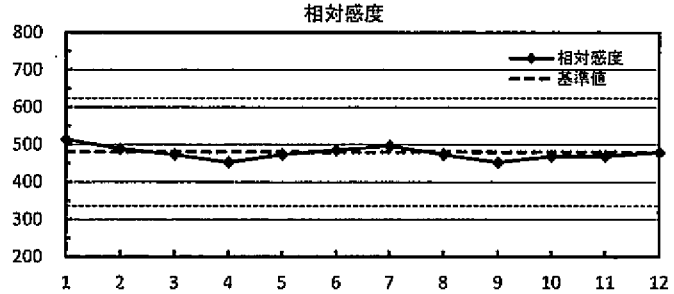


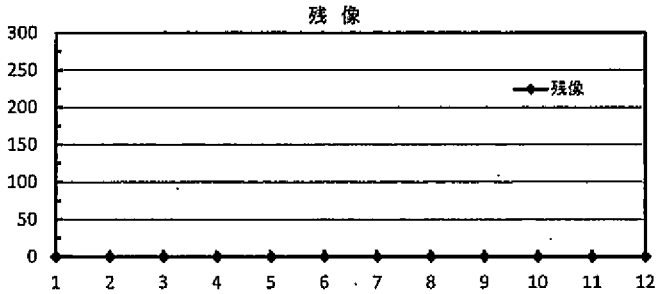


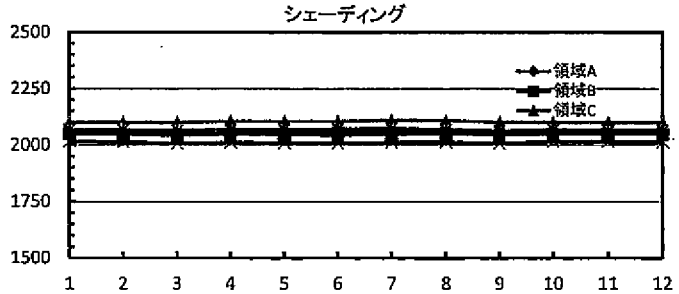


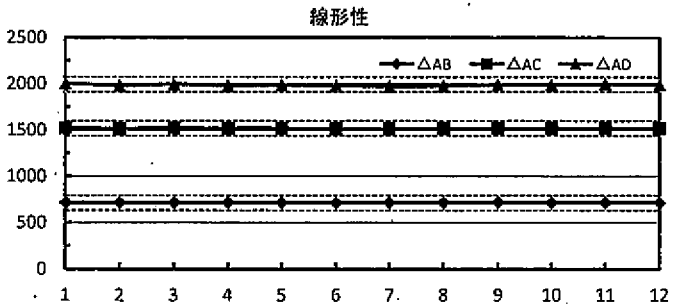


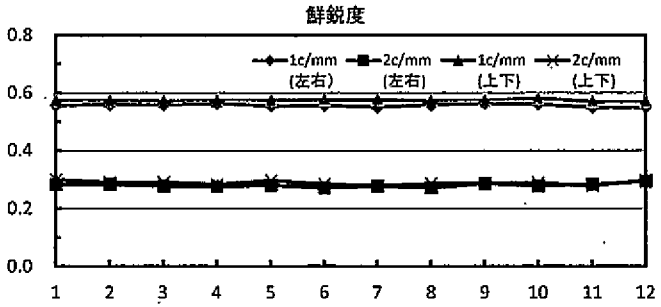


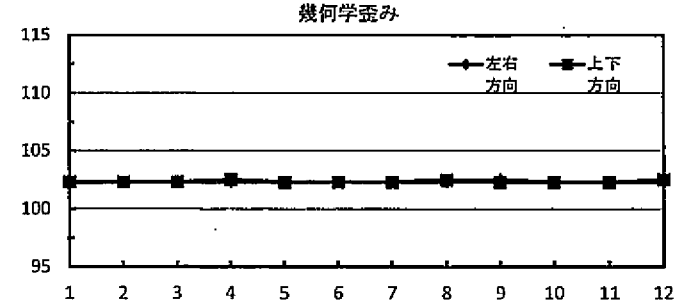


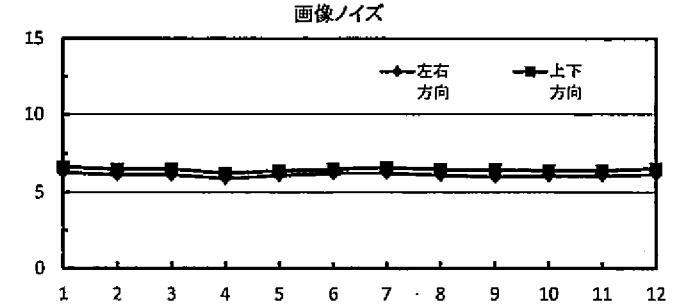


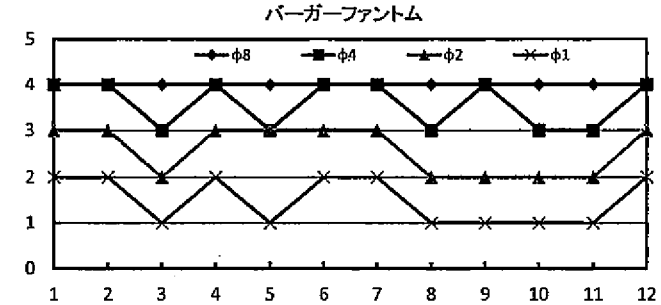


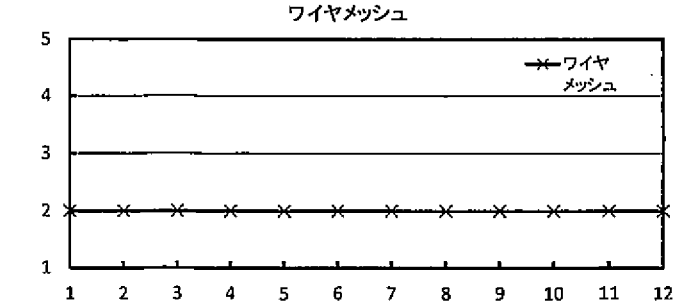

2016年度品質管理

| 画像読取装置 | CALNEO U(臥位) | | 相対感度 | 残像 | シェーディング | | | | | アーチファクト | 線形性 | | | 鮮鋭度 | | | | 幾何学歪み | | 画像ノイズ | | バーガーファントム | | | | ワイヤメッシュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置場所 | X線撮影室20 | | | | 領域A | 領域B | 領域C | 領域D | 領域E | | △AB | △AC | △AD | 1c/mm (左右) | 2c/mm (左右) | 1c/mm (上下) | 2c/mm (上下) | 左右方向 | 上下方向 | 左右方向 | 上下方向 | φ8 | φ4 | φ2 | φ1 | |
| | 管理幅 | 上限値 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | 基準値 | 626 | | 2,052 | 1,954 | 1,953 | 1,988 | 1,964 | | 698 | 1454 | 1804 | 0.5106 | 0.2608 | 0.5356 | 0.2675 | 107.0 | 106.9 | 7.3934 | 7.0129 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | | 下限値 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| No. | 検査日 | 検査時間 | 実施者 | ±30% | | ±160QL | | | | | | ±80QL | | | ±10% | | | ±3% | | ±20% | | | | | | |
| 1 | 20160409 | 14:33 | 本田 | 605 | 0 | 2054 | 1927 | 1953 | 1951 | 1959 | Pass | 697 | 1446 | 1786 | 0.5159 | 0.2573 | 0.5426 | 0.2752 | 106.8 | 107.0 | 7.3771 | 7.2257 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 20160514 | 15:05 | 本田 | 618 | 0 | 2053 | 1925 | 1944 | 1950 | 1949 | Pass | 694 | 1436 | 1772 | 0.5117 | 0.2518 | 0.5401 | 0.2605 | 106.8 | 107.0 | 7.5739 | 7.3269 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 20160625 | 15:49 | 本田 | 620 | 0 | 2057 | 1924 | 1965 | 1949 | 1969 | Pass | 696 | 1445 | 1792 | 0.5178 | 0.2560 | 0.5418 | 0.2631 | 106.8 | 107.0 | 7.4913 | 7.2546 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 20160723 | 15:38 | 本田 | 592 | 0 | 2053 | 1919 | 1955 | 1946 | 1960 | Pass | 695 | 1443 | 1782 | 0.5116 | 0.2649 | 0.5458 | 0.2700 | 106.8 | 107.0 | 7.4739 | 7.1275 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 20160819 | 20:24 | 本田 | 608 | 0 | 2050 | 1915 | 1959 | 1941 | 1963 | Pass | 696 | 1449 | 1790 | 0.5192 | 0.2541 | 0.5401 | 0.2692 | 106.8 | 107.0 | 7.5242 | 7.2373 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 20160916 | 20:07 | 本田 | 608 | 0 | 2048 | 1907 | 1976 | 1932 | 1980 | Pass | 691 | 1436 | 1771 | 0.5180 | 0.2672 | 0.5315 | 0.2669 | 106.8 | 107.0 | 7.6124 | 7.2538 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | 20161022 | 16:37 | 本田 | 608 | 0 | 2049 | 1909 | 1959 | 1939 | 1966 | Pass | 697 | 1446 | 1785 | 0.5197 | 0.2679 | 0.5361 | 0.2725 | 106.8 | 106.8 | 7.5965 | 7.2358 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | 20161126 | 15:15 | 本田 | 608 | 0 | 2056 | 1923 | 1961 | 1951 | 1969 | Pass | 694 | 1444 | 1786 | 0.5139 | 0.2489 | 0.5289 | 0.2629 | 106.8 | 106.8 | 7.4175 | 7.2000 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | 20161224 | 14:50 | 本田 | 592 | 0 | 2055 | 1924 | 1960 | 1947 | 1965 | Pass | 695 | 1445 | 1788 | 0.5047 | 0.2590 | 0.5454 | 0.2665 | 106.8 | 107.0 | 7.3500 | 7.1249 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | 20170114 | 14:24 | 本田 | 604 | 0 | 2047 | 1920 | 1953 | 1942 | 1958 | Pass | 695 | 1443 | 1780 | 0.5066 | 0.2591 | 0.5326 | 0.2715 | 106.8 | 107.0 | 7.3414 | 7.1609 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | 20170225 | 13:20 | 本田 | 620 | 0 | 2048 | 1917 | 1953 | 1940 | 1961 | Pass | 694 | 1444 | 1787 | 0.5085 | 0.2636 | 0.5420 | 0.2587 | 107.0 | 106.8 | 7.4312 | 7.2794 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 20170318 | 14:27 | 本田 | 620 | 0 | 2055 | 1930 | 1959 | 1949 | 1961 | Pass | 695 | 1441 | 1776 | 0.5195 | 0.2544 | 0.5375 | 0.2601 | 107.0 | 106.8 | 7.3144 | 7.2079 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |

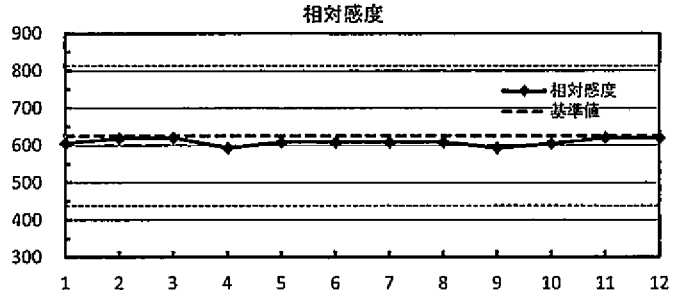


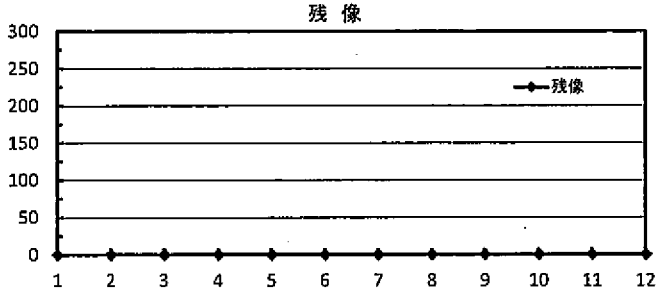


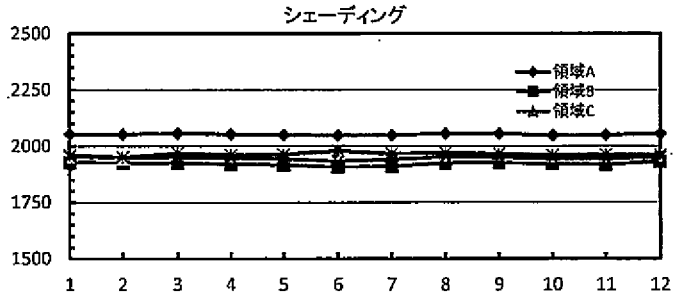


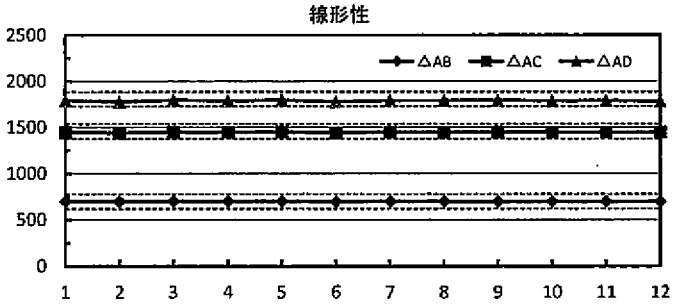


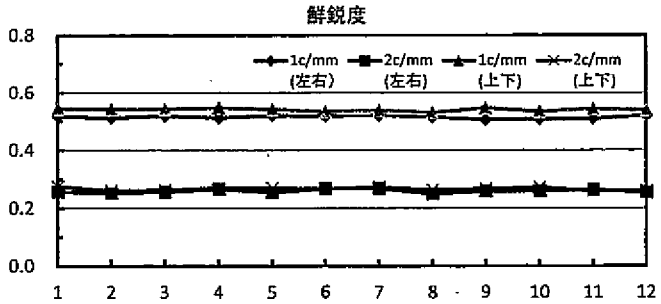


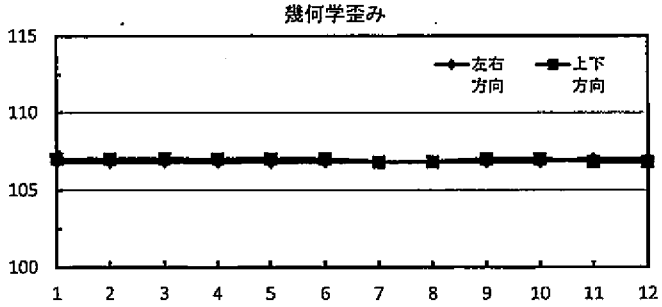


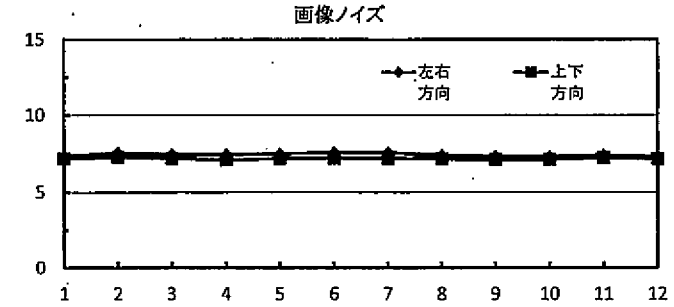


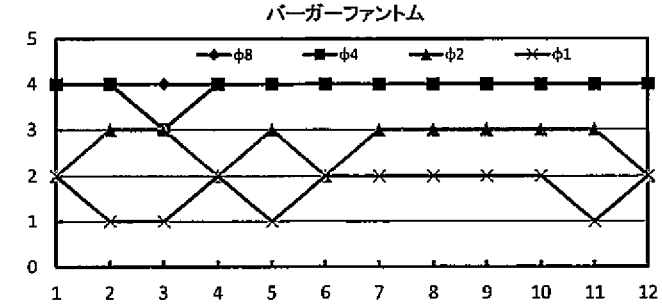


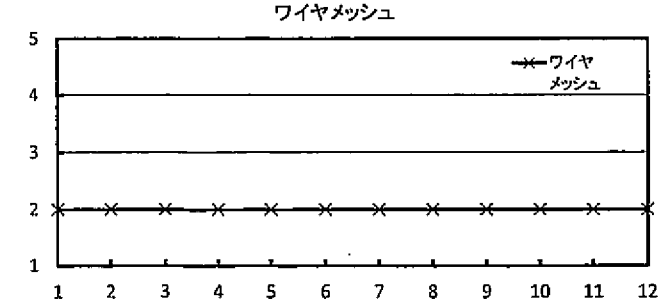

2016年度品質管理

| 画像読取装置 | CALNEO U(立位) | | | 相対感度 | 残像 | シェーディング | | | | | アーチファクト | 線形性 | | | 鮮鋭度 | | | | 幾何学歪み | | 画像ノイズ | | バーガーファントム | | | | ワイヤメッシュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置場所 | X線撮影室22 | | | | | 領域A | 領域B | 領域C | 領域D | 領域E | | △AB | △AC | △AD | 1c/mm (左右) | 2c/mm (左右) | 1c/mm (上下) | 2c/mm (上下) | 左右方向 | 上下方向 | 左右方向 | 上下方向 | φ8 | φ4 | φ2 | φ1 | |
| | 管理幅 | 上限値 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | | 基準値 | 438 | | 2,053 | 2,050 | 2,048 | 2,042 | 2,036 | | 720 | 1538 | 2028 | 0.5493 | 0.2791 | 0.5584 | 0.2798 | 102.4 | 102.4 | 6.0840 | 6.1301 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | | 下限値 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| No. | 検査日 | 検査時間 | 実施者 | ±30% | | ±160QL | | | | | | ±80QL | | | ±10% | | | | ±3% | | ±20% | | | | | | |
| 1 | 20160409 | 14:07 | 本田 | 455 | 0 | 2054 | 2028 | 2059 | 2039 | 2038 | Pass | 719 | 1532 | 2021 | 0.5598 | 0.2785 | 0.5727 | 0.2803 | 102.5 | 102.3 | 5.8942 | 5.9660 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 20160514 | 14:30 | 本田 | 444 | 0 | 2054 | 2029 | 2056 | 2042 | 2030 | Pass | 719 | 1530 | 2010 | 0.5587 | 0.2826 | 0.5662 | 0.2707 | 102.3 | 102.5 | 5.7968 | 5.8780 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 20160625 | 14:59 | 本田 | 437 | 0 | 2053 | 2030 | 2056 | 2041 | 2024 | Pass | 719 | 1530 | 2016 | 0.5545 | 0.2905 | 0.5625 | 0.2794 | 102.5 | 102.3 | 5.7449 | 5.8014 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 20160723 | 15:10 | 本田 | 447 | 0 | 2054 | 2025 | 2057 | 2039 | 2031 | Pass | 716 | 1519 | 1987 | 0.5539 | 0.2813 | 0.5528 | 0.2772 | 102.3 | 102.5 | 5.8345 | 5.8700 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 20160819 | 19:54 | 本田 | 458 | 0 | 2051 | 2026 | 2052 | 2038 | 2022 | Pass | 718 | 1528 | 2003 | 0.5561 | 0.2818 | 0.5608 | 0.2760 | 102.5 | 102.3 | 5.9113 | 5.9763 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | 20160916 | 19:47 | 本田 | 428 | 0 | 2049 | 2022 | 2054 | 2033 | 2027 | Pass | 718 | 1526 | 1998 | 0.5599 | 0.2796 | 0.5594 | 0.2775 | 102.3 | 102.5 | 5.7358 | 5.7763 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | 20161022 | 16:13 | 本田 | 458 | 0 | 2053 | 2024 | 2055 | 2039 | 2030 | Pass | 719 | 1530 | 2013 | 0.5602 | 0.2813 | 0.5586 | 0.2740 | 102.3 | 102.3 | 5.9080 | 5.9649 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | 20161126 | 14:52 | 本田 | 428 | 0 | 2056 | 2035 | 2058 | 2046 | 2025 | Pass | 719 | 1531 | 2016 | 0.5448 | 0.2795 | 0.5599 | 0.2797 | 102.5 | 102.5 | 5.6651 | 5.7379 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | 20161224 | 14:31 | 本田 | 437 | 0 | 2053 | 2030 | 2055 | 2041 | 2025 | Pass | 719 | 1529 | 2009 | 0.5545 | 0.2807 | 0.5615 | 0.2680 | 102.5 | 102.5 | 5.7324 | 5.8062 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | 20170114 | 13:19 | 本田 | 429 | 0 | 2046 | 2024 | 2048 | 2036 | 2019 | Pass | 721 | 1537 | 2021 | 0.5571 | 0.2784 | 0.5582 | 0.2782 | 102.5 | 102.3 | 5.7224 | 5.7884 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | 20170225 | 12:57 | 本田 | 429 | 0 | 2049 | 2027 | 2050 | 2039 | 2024 | Pass | 718 | 1533 | 2022 | 0.5571 | 0.2784 | 0.5608 | 0.2750 | 102.3 | 102.3 | 5.6909 | 5.7601 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | 20170318 | 14:07 | 本田 | 438 | 0 | 2050 | 2027 | 2051 | 2038 | 2025 | Pass | 720 | 1535 | 2018 | 0.5578 | 0.2760 | 0.5597 | 0.2800 | 102.3 | 102.3 | 5.7576 | 5.8277 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |

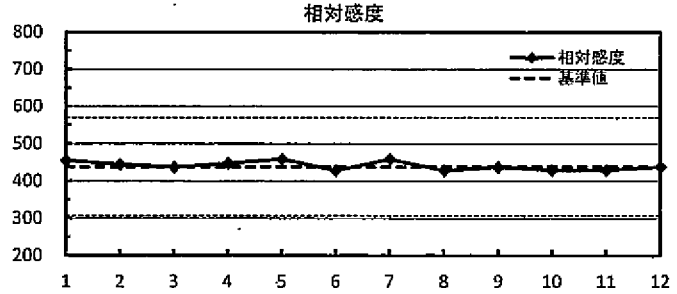


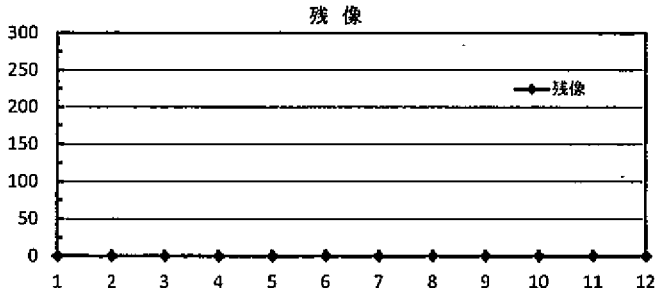


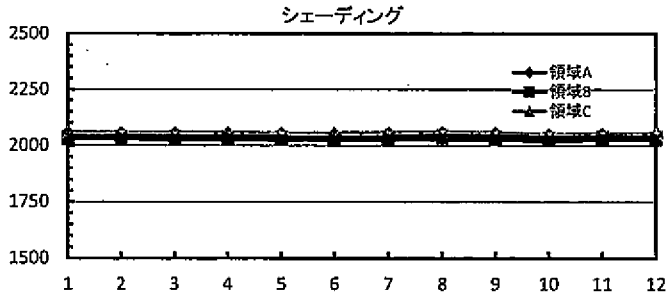


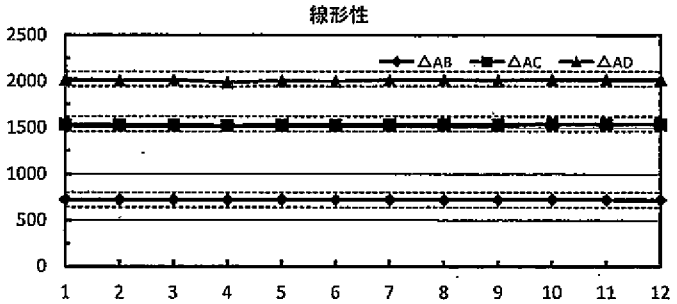


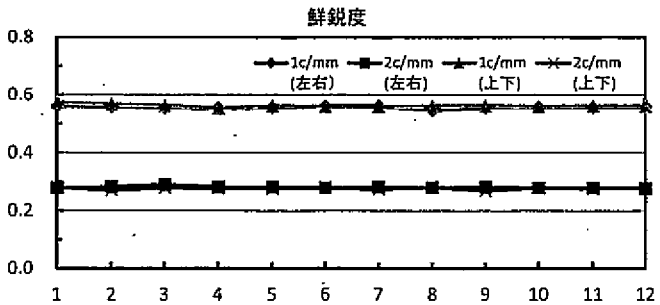


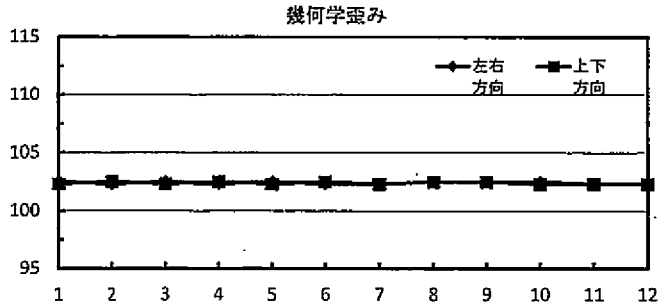


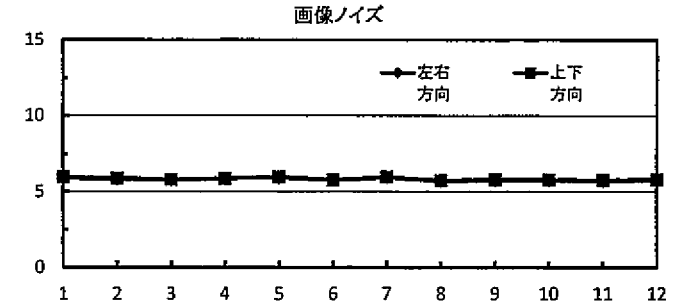


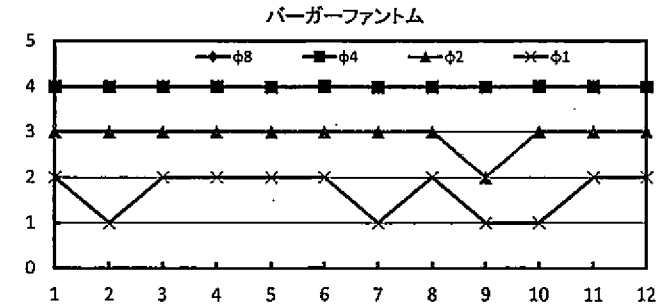


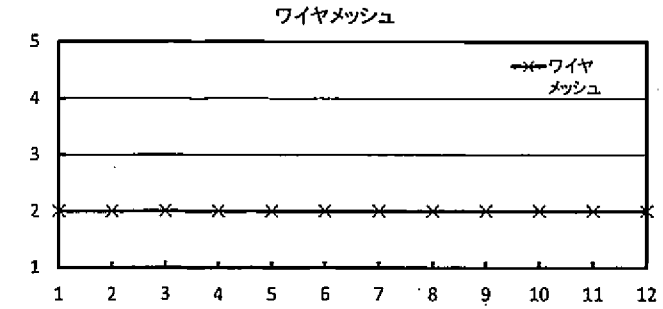

2016年度品質管理
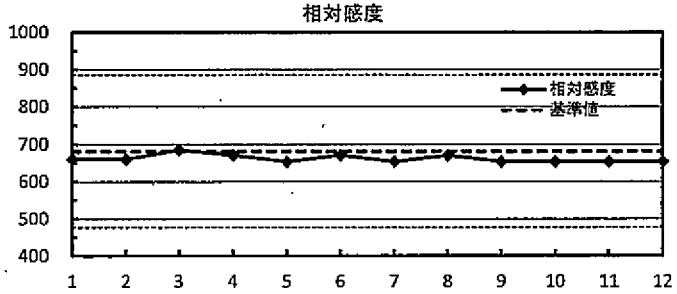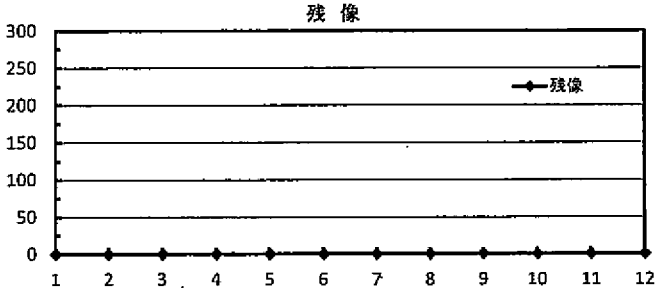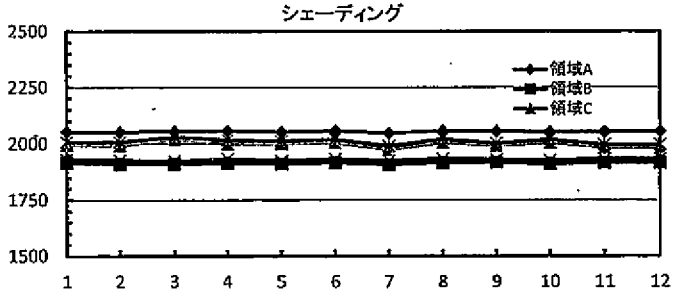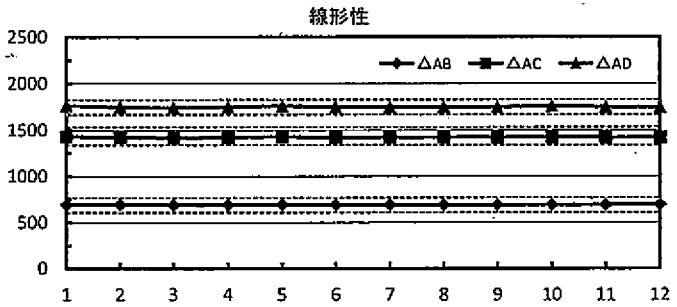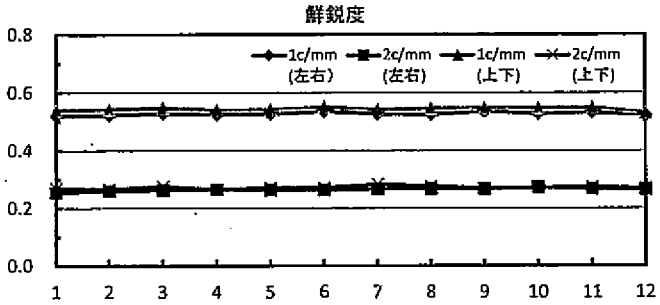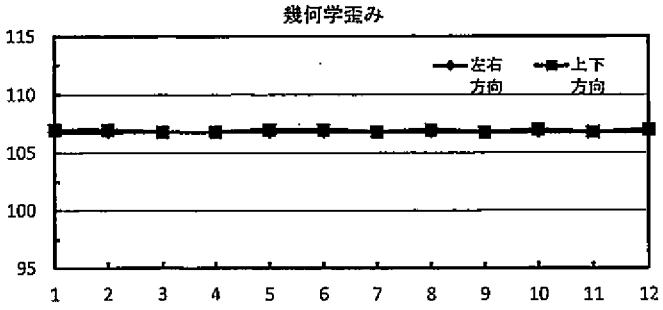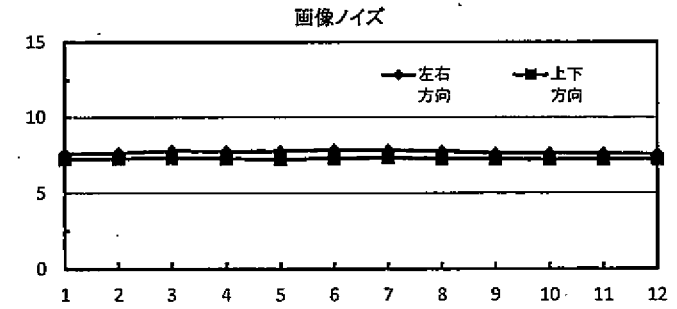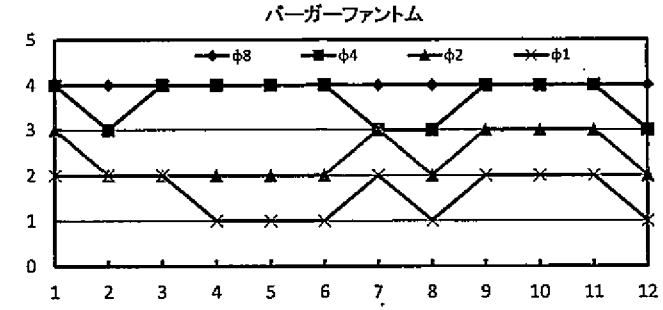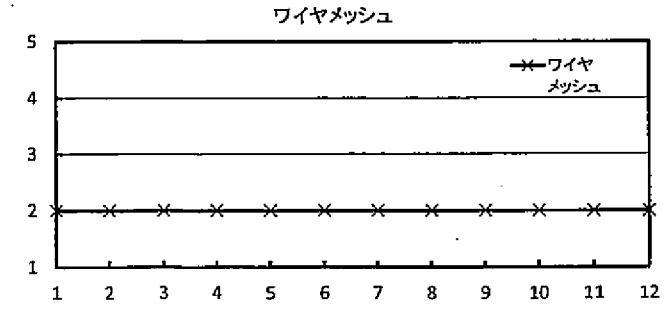
| 画像読取装置 | | CALNEO U(臥位) | 相対感度 | 残像 | シェーディング | | | | | アーチファクト | 線形性 | | | 鮮鋭度 | | | | 幾何学歪み | | 画像ノイズ | | バーガーファントム | | | | ワイヤメッシュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置場所 | | X線撮影室22 | | | 領域A | 領域B | 領域C | 領域D | 領域E | | △AB | △AC | △AD | 1c/mm (左右) | 2c/mm (左右) | 1c/mm (上下) | 2c/mm (上下) | 左右方向 | 上下方向 | 左右方向 | 上下方向 | φ8 | φ4 | φ2 | φ1 | |
| | 管理幅 | 上限値 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| | | 基準値 | 681 | | 2,053 | 1,935 | 2,001 | 1,954 | 2,020 | | 687 | 1419 | 1748 | 0.5290 | 0.2686 | 0.5409 | 0.2705 | 106.9 | 106.9 | 7.9712 | 7.4928 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | | 下限値 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| No. | 検査日 | 検査時間 | 実施者 | ±30% | | ±160QL | | | | | ±80QL | | | ±10% | | | | ±3% | | ±20% | | | | | | |
| 1 | 20160409 | 14:14 | 本田 | 660 | 0 | 2053 | 1917 | 1996 | 1931 | 2007 | Pass | 693 | 1432 | 1763 | 0.5199 | 0.2534 | 0.5391 | 0.2693 | 106.8 | 107.0 | 7.5851 | 7.2199 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 20160514 | 14:44 | 本田 | 660 | 0 | 2051 | 1911 | 1993 | 1927 | 2007 | Pass | 692 | 1423 | 1747 | 0.5221 | 0.2608 | 0.5416 | 0.2658 | 106.8 | 107.0 | 7.6338 | 7.2650 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 20160625 | 15:13 | 本田 | 685 | 0 | 2054 | 1912 | 2020 | 1924 | 2030 | Pass | 688 | 1417 | 1738 | 0.5278 | 0.2629 | 0.5477 | 0.2761 | 106.8 | 106.8 | 7.7896 | 7.3287 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 20160723 | 15:21 | 本田 | 671 | 0 | 2056 | 1914 | 1999 | 1933 | 2016 | Pass | 690 | 1420 | 1746 | 0.5248 | 0.2653 | 0.5395 | 0.2654 | 106.8 | 106.8 | 7.7517 | 7.2720 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 5 | 20160819 | 20:02 | 本田 | 654 | 0 | 2051 | 1913 | 2001 | 1925 | 2011 | Pass | 692 | 1428 | 1759 | 0.5262 | 0.2644 | 0.5415 | 0.2723 | 106.8 | 107.0 | 7.7559 | 7.2129 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 20160916 | 19:54 | 本田 | 671 | 0 | 2056 | 1917 | 2005 | 1932 | 2018 | Pass | 689 | 1418 | 1746 | 0.5347 | 0.2636 | 0.5499 | 0.2712 | 106.8 | 107.0 | 7.8447 | 7.2815 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 20161022 | 16:20 | 本田 | 654 | 0 | 2046 | 1908 | 1975 | 1925 | 1989 | Pass | 690 | 1421 | 1746 | 0.5259 | 0.2670 | 0.5403 | 0.2837 | 106.8 | 106.8 | 7.8176 | 7.3221 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | 20161126 | 14:59 | 本田 | 671 | 0 | 2056 | 1917 | 2005 | 1933 | 2021 | Pass | 689 | 1423 | 1750 | 0.5239 | 0.2684 | 0.5447 | 0.2769 | 106.8 | 107.0 | 7.7631 | 7.2701 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | 20161224 | 14:37 | 本田 | 654 | 0 | 2054 | 1918 | 1992 | 1930 | 2001 | Pass | 690 | 1420 | 1746 | 0.5345 | 0.2668 | 0.5460 | 0.2693 | 106.8 | 106.8 | 7.6263 | 7.2327 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | 20170114 | 13:36 | 本田 | 654 | 0 | 2050 | 1910 | 2004 | 1926 | 2018 | Pass | 690 | 1424 | 1756 | 0.5265 | 0.2720 | 0.5460 | 0.2705 | 106.8 | 107.0 | 7.6445 | 7.2153 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 11 | 20170225 | 13:05 | 本田 | 654 | 0 | 2051 | 1917 | 1983 | 1932 | 1995 | Pass | 690 | 1420 | 1747 | 0.5313 | 0.2668 | 0.5465 | 0.2741 | 106.8 | 106.8 | 7.6183 | 7.2416 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | 20170318 | 14:13 | 本田 | 654 | 0 | 2053 | 1917 | 1981 | 1934 | 1995 | Pass | 691 | 1422 | 1746 | 0.5216 | 0.2652 | 0.5302 | 0.2690 | 106.8 | 107.0 | 7.5586 | 7.2534 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |